


编号: YNH/AJ-15-33-2016

生化分析仪用清洗液/剂出厂检验报告

清洗率	清洗率大于 90%。	98.4%	√
结论	检验是合格。	合格	

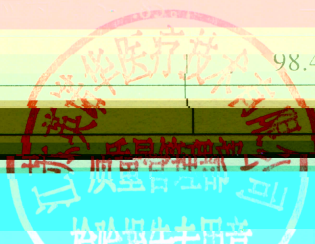

2016

2016

2016