

编号: YNH/AJ-15-14-2024

清洗液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求: 苏镇械备 20240094

检验日期: 2025.12.25


试剂批号: 22512241

产品型号: PLR-02

配套器械批号: 20251225

仪器编号	P2HH001C	600408N0016120545
------	----------	-------------------

检验项目	要求	检验结果				结果判定 合格(√); 不合格(×)
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				√
净含量	不低于标识值 5L	5.02L	5.03L	5.02L	5.03L	√
pH 值	25±1℃时, 7.00±0.50	检测温度: 25.0℃				√
		7.15	7.14	7.15	7.15	
空白值	PLT ≤ 10×10 ⁹ /L	0	0	0	0	√
	PLT ≤ 10×10 ⁹ /L	0	0	0	0	√
结论	检验是否合格					

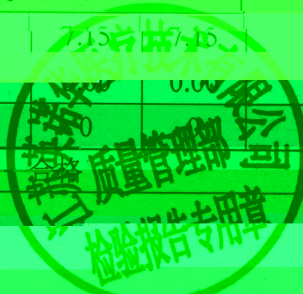

检验人: 张

复核人: 李

批准人: 周涛