

编号: YNH/AJ-15-13-2024

产品型号: PLR-01


配套清洗液批号: 22603251

试剂规格: 1L、20L

设备信息:

仪器名称	血小板分析仪	PH计	电导率仪	冰点渗透压
仪器型号	PL-12	PHS-3C	DDSI-303A	FM-8P

检测项目	要求	检测结果	判定
外观	洁净透明, 无异物、霉斑	合格	合格
液位	不低于标示值	200mL	合格
pH值	6.5-8.5	7.18	合格
电导率	25℃时, $17.20 \pm 0.30 \pm 0.05$	17.34	合格
渗透压	$1.00 \pm 0.02 \text{ mOsm/kg}$	1.03	合格
空白值	$CV \leq 2.5 \times 10^{-3}$	0.00	合格
结论	该批清洗液合格		合格

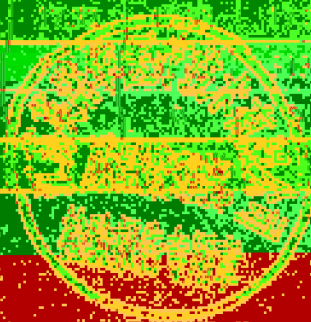

日期:

页码: